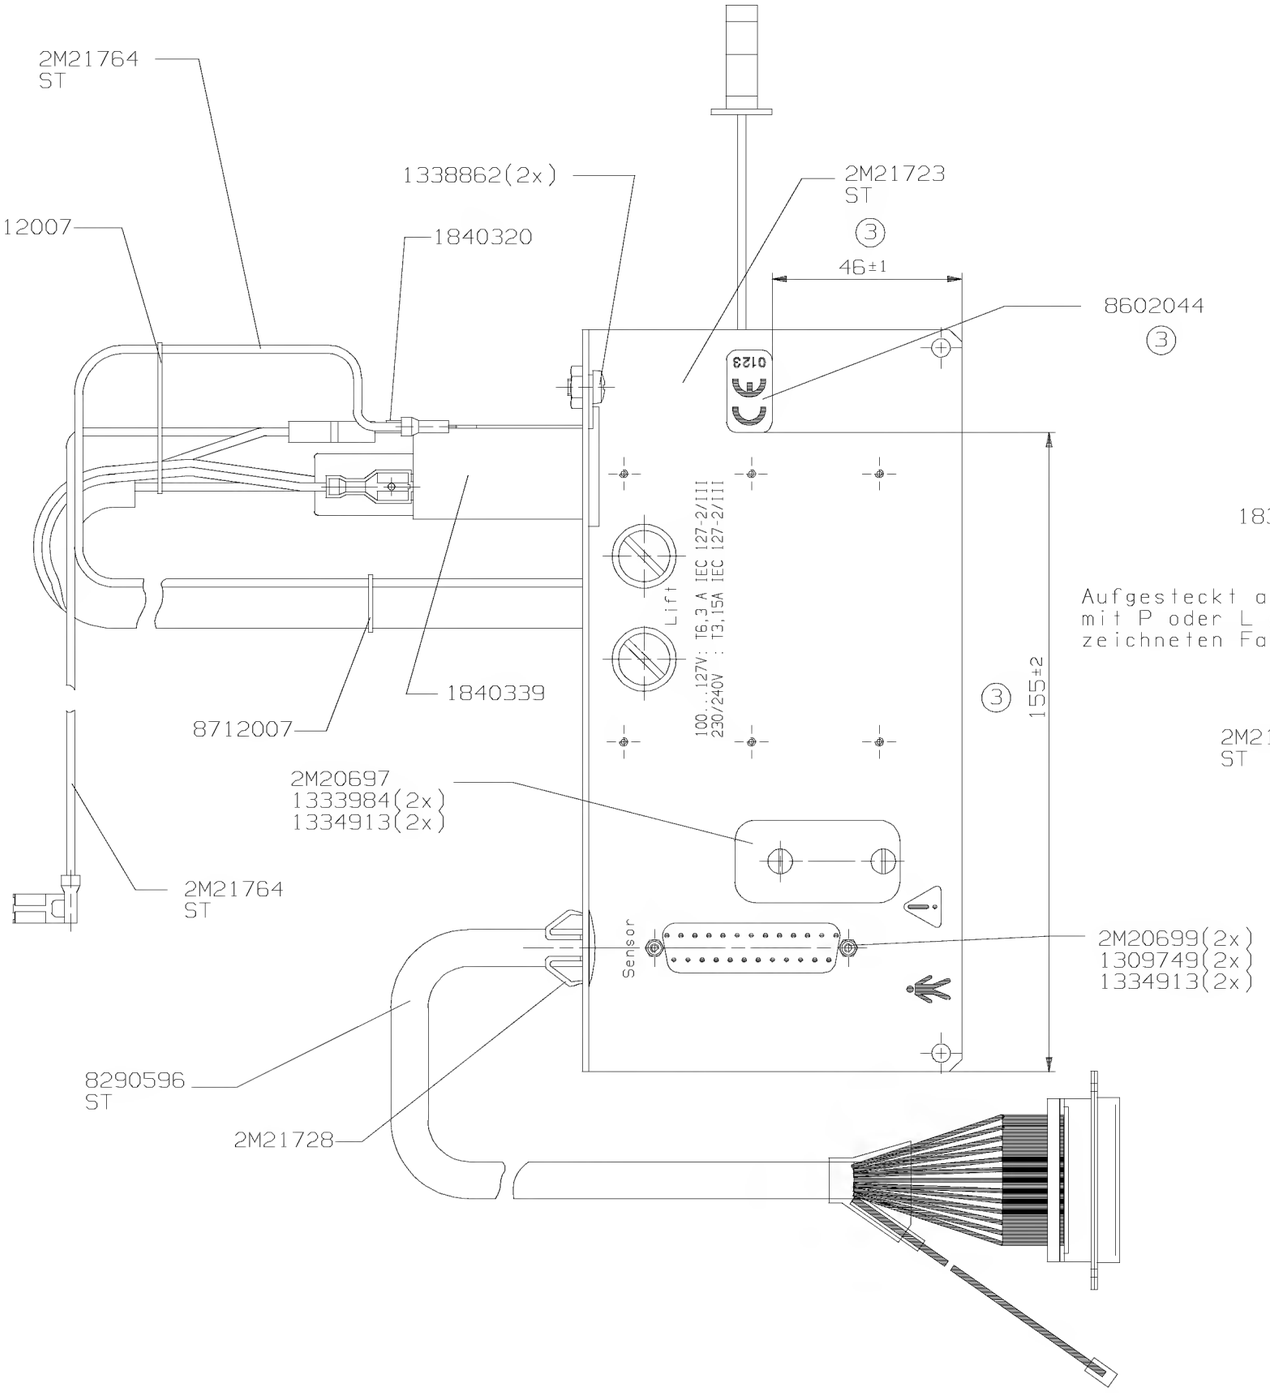

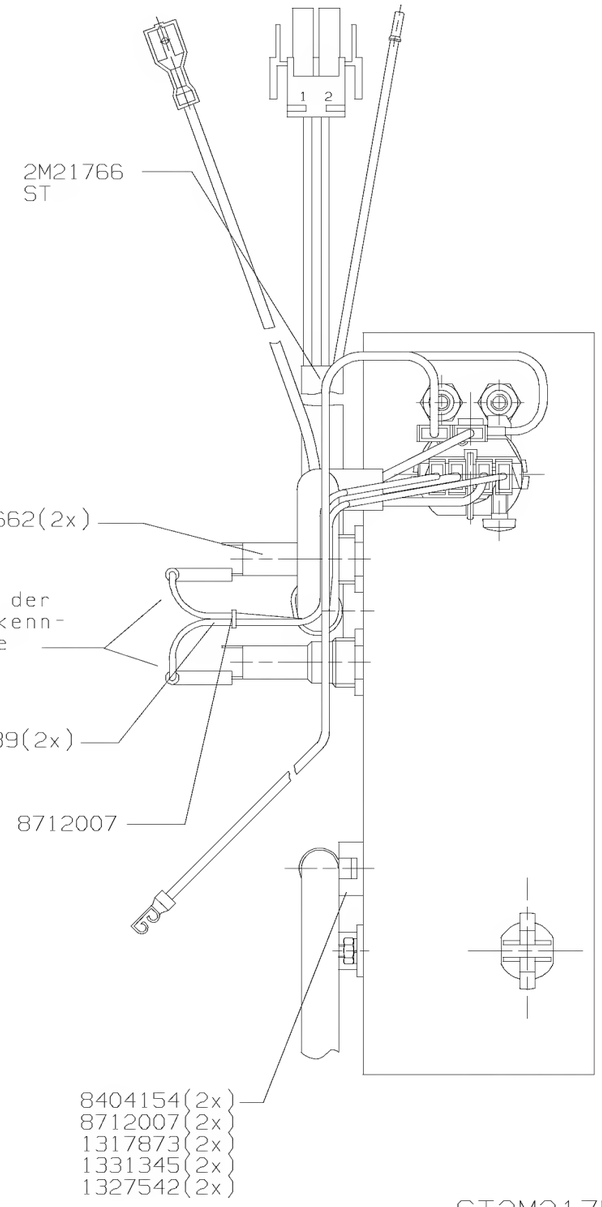

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use or the document / contents is forbidden
without our permission. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

Lose Teile verpackt in Flachbeutel mind.
200x180 DWN 1210:

2 Stck	Schraube	1338382
1 Stck	Kappe	2M20356
2 Stck	Kabelbinder	8712007

ST2M21756

scale: 1:1	general tolerances: ---	material: ---	safety class: <s> 0, <m> 0	
field reserved	revision text: Schild und Masze nachgetragen (1998/CC/135)			
filing dept.: 2530	responsible dept.: 3401		author	approved
		date	27.04.1998	27.04.1998
		name	Stickel	Hartwig
canIract: n				
type: drawing	language: de	title: Netzanschlusz IC		
	replacement for: 2M21756-02	number: 2M21756		
creating system: CADRA	release status: PROD	revision index: 03	accures: 03	page/of: 01/01

Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A2

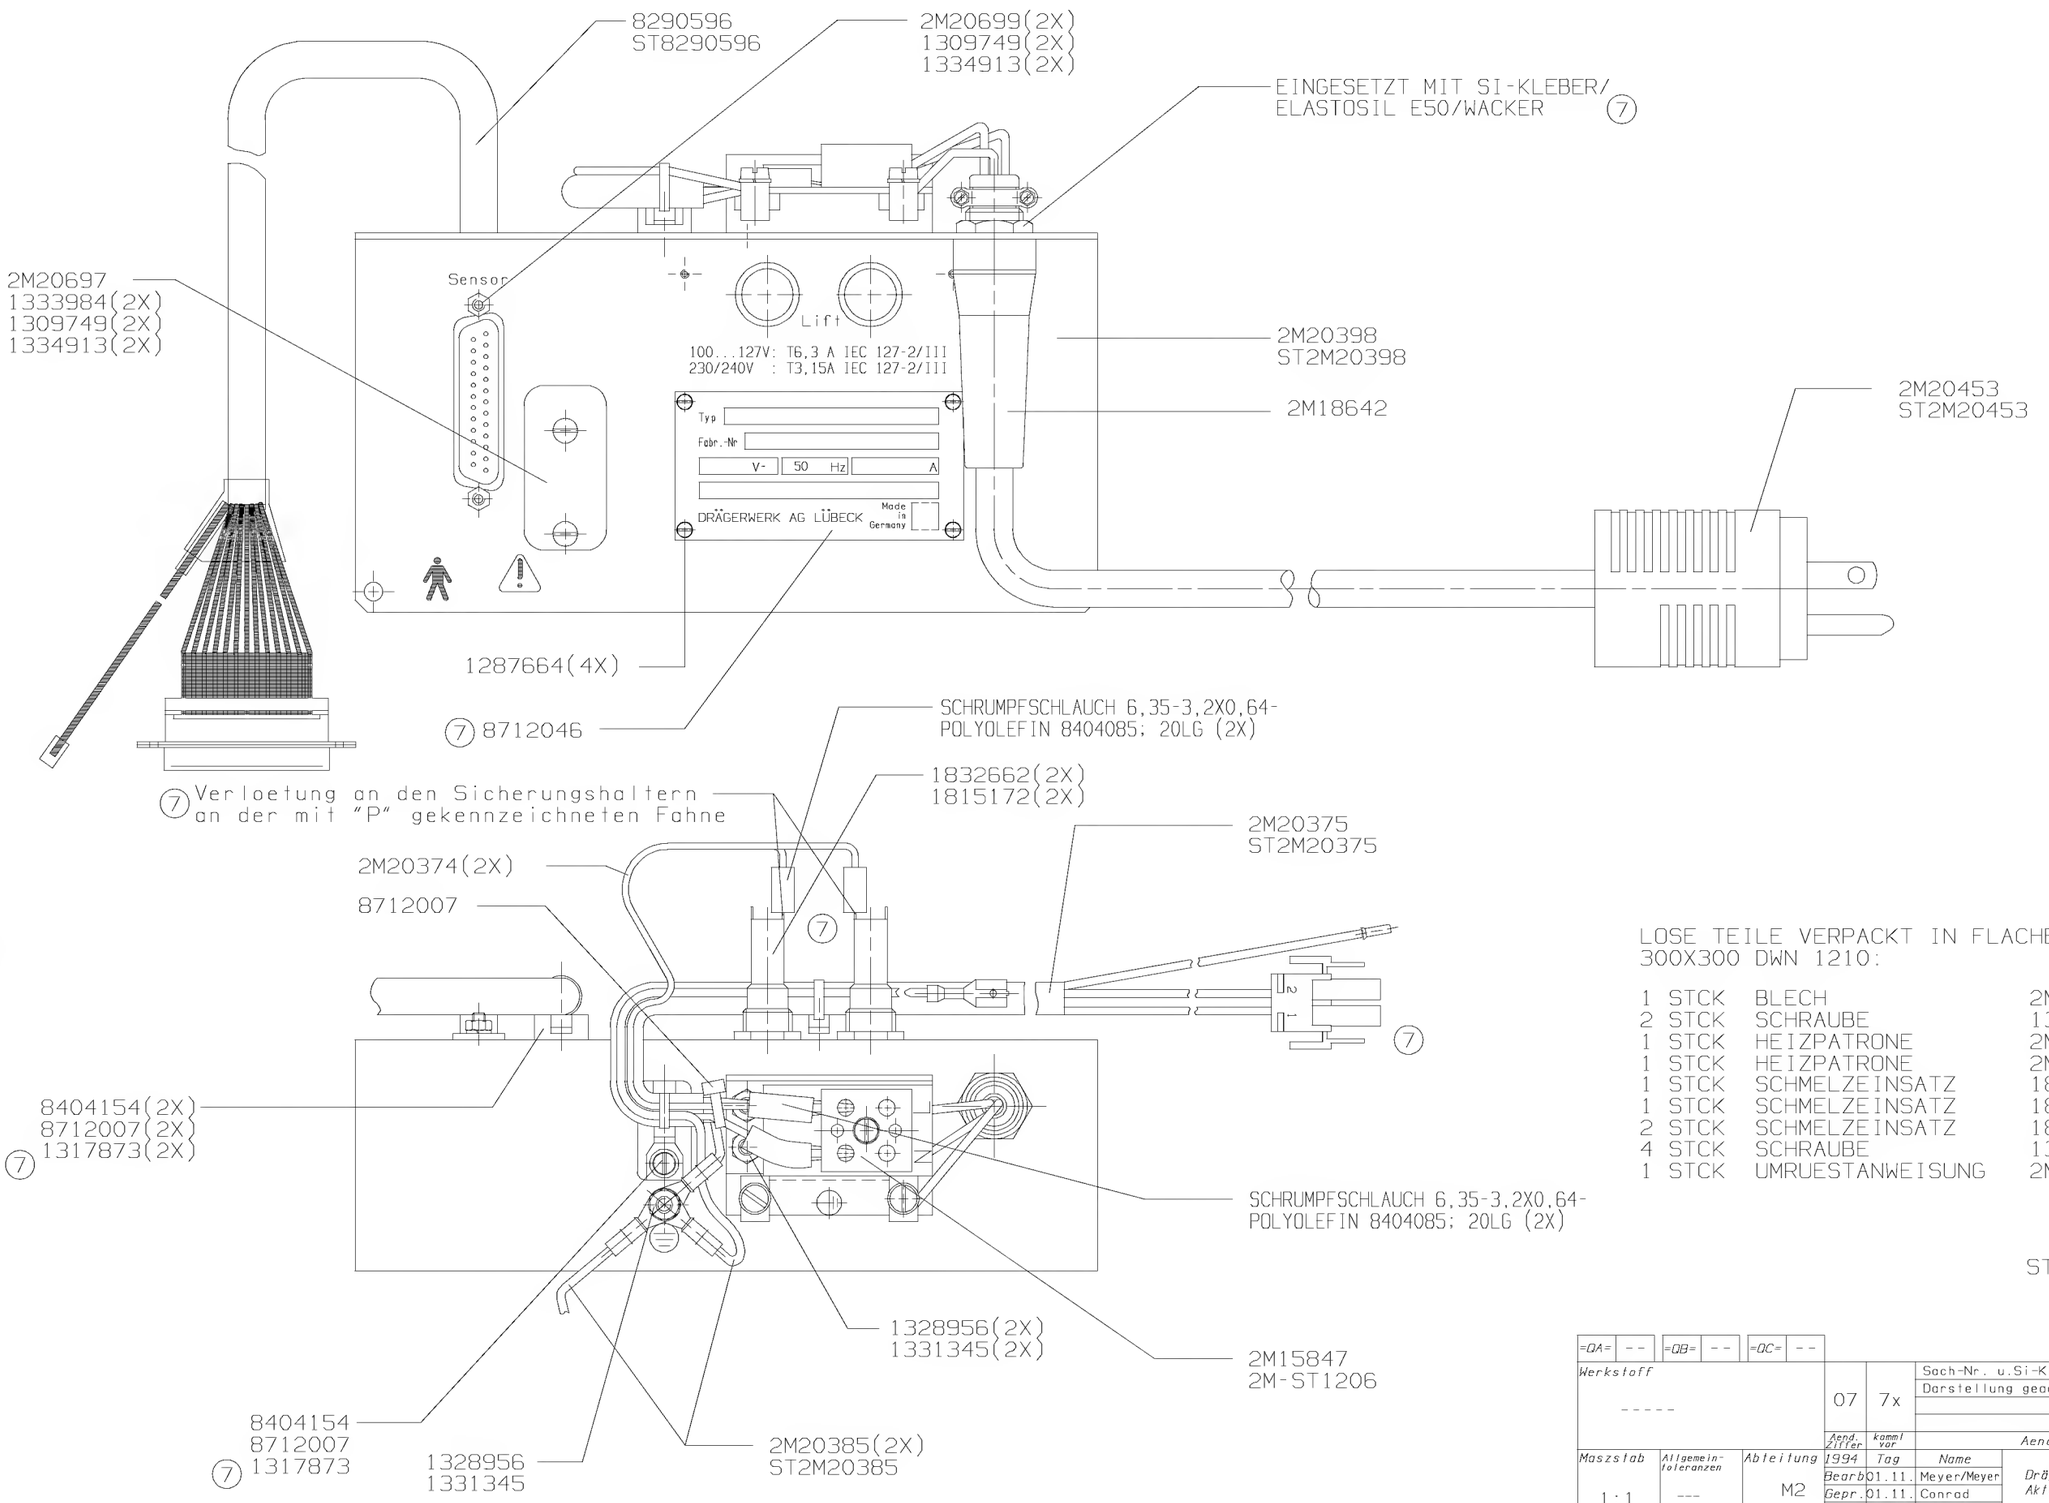

LOSE TEILE VERPACKT IN FLACHBEUTEL MIND. 300X300 DWN 1210:

1	STCK	BLECH	2M20461, ST2M20461
2	STCK	SCHRAUBE	1338382
1	STCK	HEIZPATRONE	2M20328
1	STCK	HEIZPATRONE	2M20331
1	STCK	SCHMELZEINSATZ	1814974
1	STCK	SCHMELZEINSATZ	1815083
2	STCK	SCHMELZEINSATZ	1815172
4	STCK	SCHRAUBE	1338072
1	STCK	UMRUESTANWEISUNG	2M20555

ST2M20425

=QA= -- =QB= -- =QC= --

Werkstoff: -----

Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen
07	7x	Sach-Nr. u.Si-Kleber geaendert;Sach-Nr. entfallen:
		Darstellung geaendert; Text neu
		(33/94)

Maszstab	Allgemeintoleranzen	Abteilung	1994	Tag	Name
1:1	---	M2	Bearb	01.11.	Meyer/Meyer
			Gepr.	01.11.	Conrad
				--	--

Drägerwerk Aktiengesellschaft

PROD CADRA=8

Benennung: Netzanschlusz 8000 IC (120V)

Zeichnungs-Nr.: 2M20425

Ersatz fuer 2M20425-06

Ersetzt durch

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express written permission.
All rights reserved
© Dräger & Co. KG

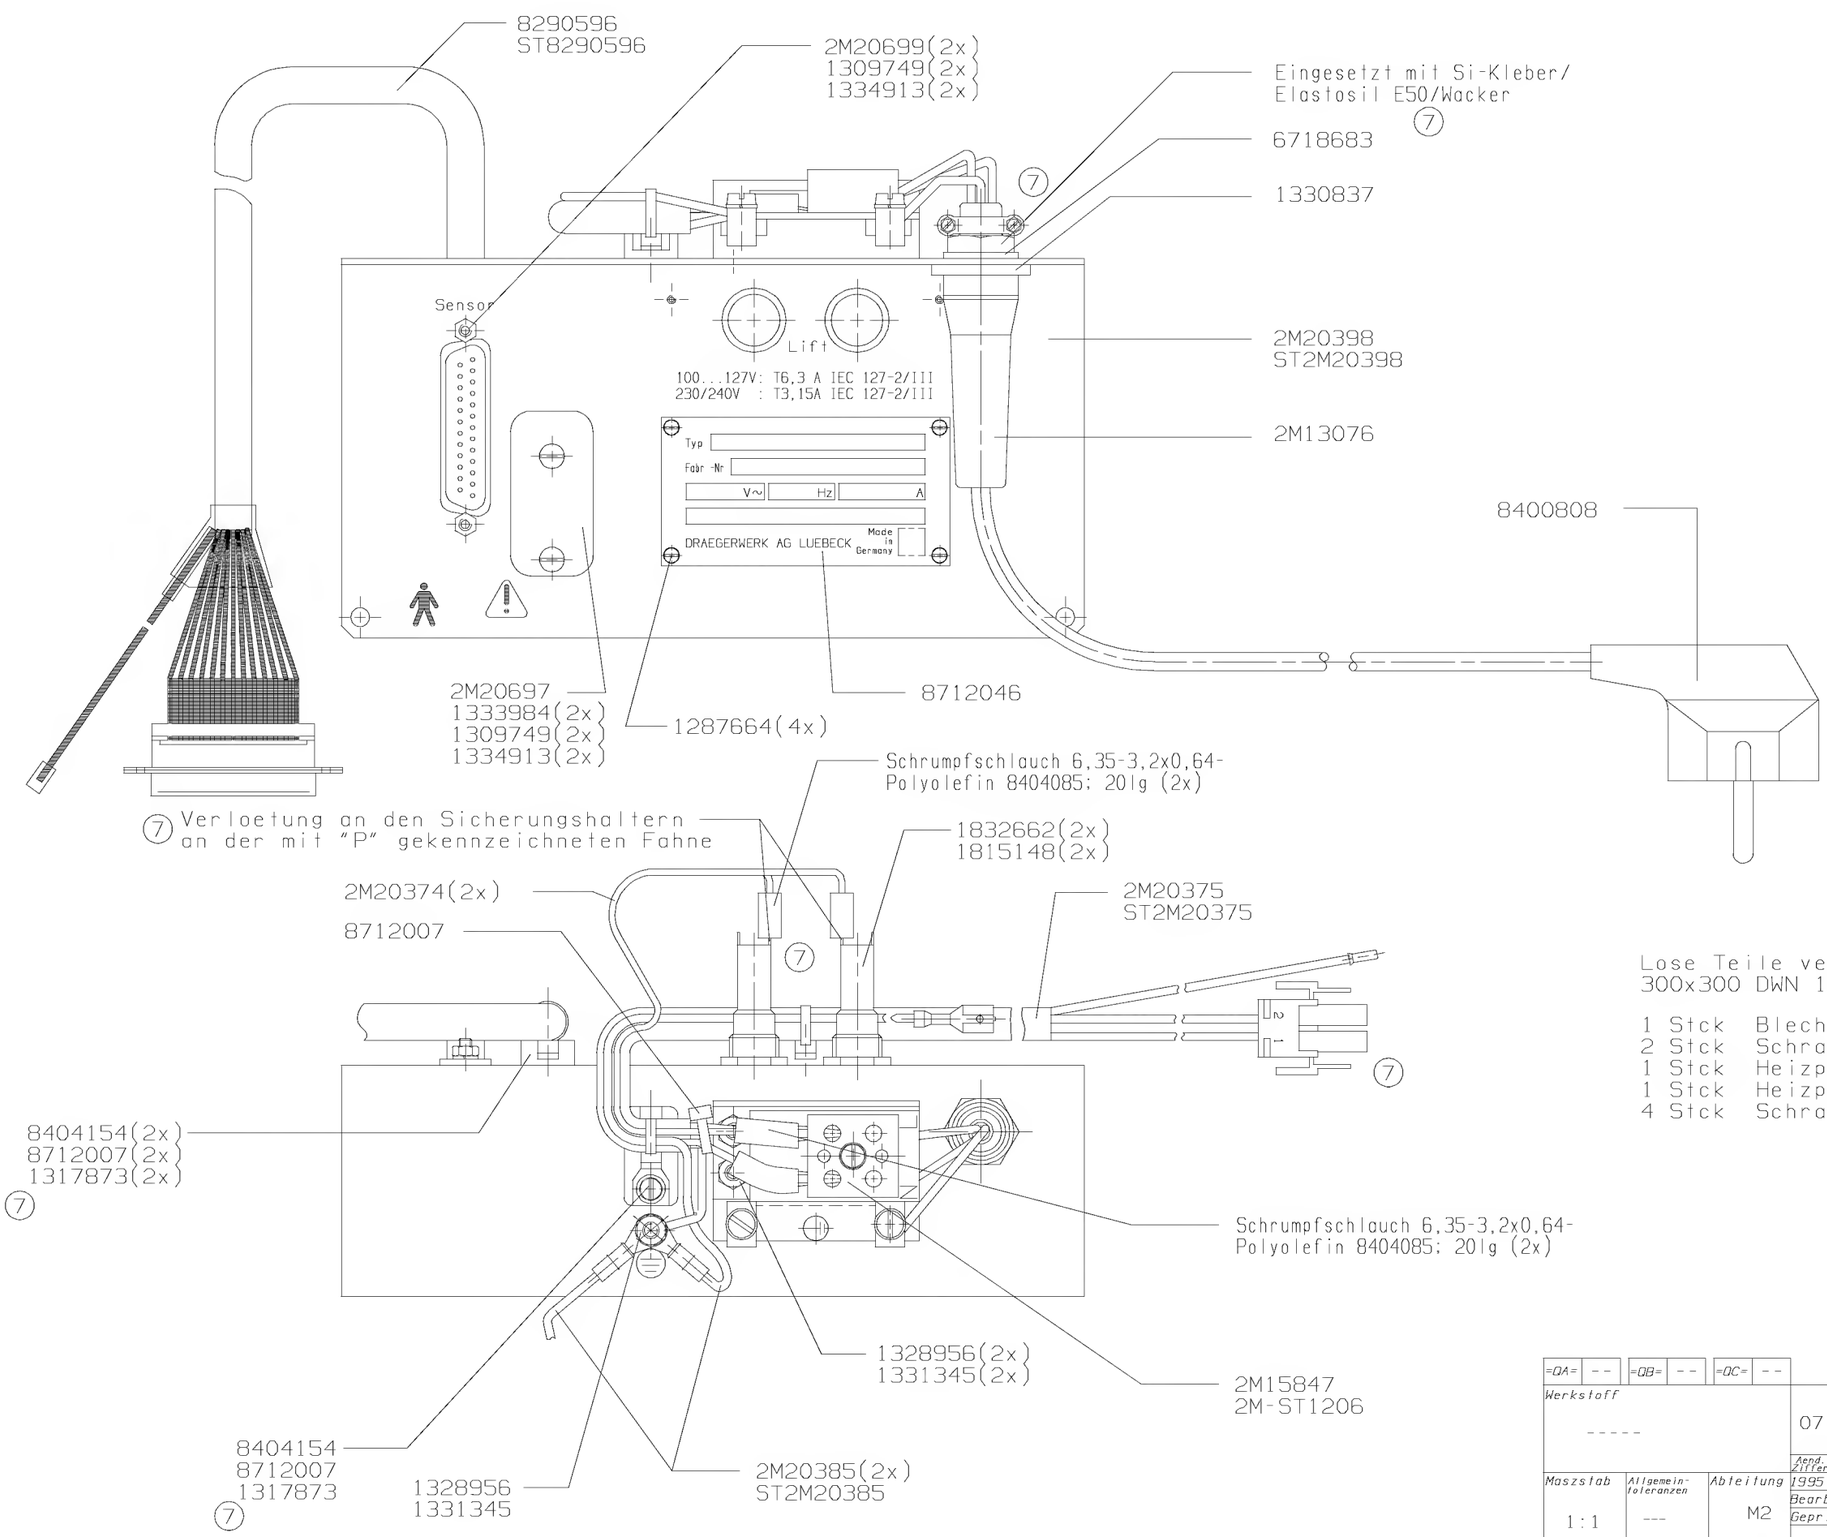

Lose Teile verpackt in Flachbeutel mind. 300x300 DWN 1210:

1 Stck	Blech	2M20461, ST2M20461
2 Stck	Schraube	1338382
1 Stck	Heizpatrone	2M20327
1 Stck	Heizpatrone	2M20329
4 Stck	Schraube	1338072

ST2M20421

=QA= -- =QB= -- =QC= --

Werkstoff: -----

Aend. Ziffer	kamml vor	Aenderungen
07	7x	Sach-Nr. entfallen und Darstellung der Fertigung angepaszt; Si-Kleber geaendert
		(41/95)

Maszstab	Allgemeintoleranzen	Abteilung	1995	Tag	Name
1:1	---	M2	Bearb	22.02.	Meyer/Meyer
			Gepr.	22.02.	Conrad
				--	--

Dräger
Drägerwerk Aktiengesellschaft

PROD CADRA=8

Benennung: Netzanschlusz 8000 IC (230V)

Zeichnungs-Nr. 2M20421

Ersatz fuer 2M20421-06

Ersetzt durch

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Use of the document/ contents is forbidden
without express author. by Dräger. All rights reserved
in the event of the grant or the registration of a
DRÄGER PATENT

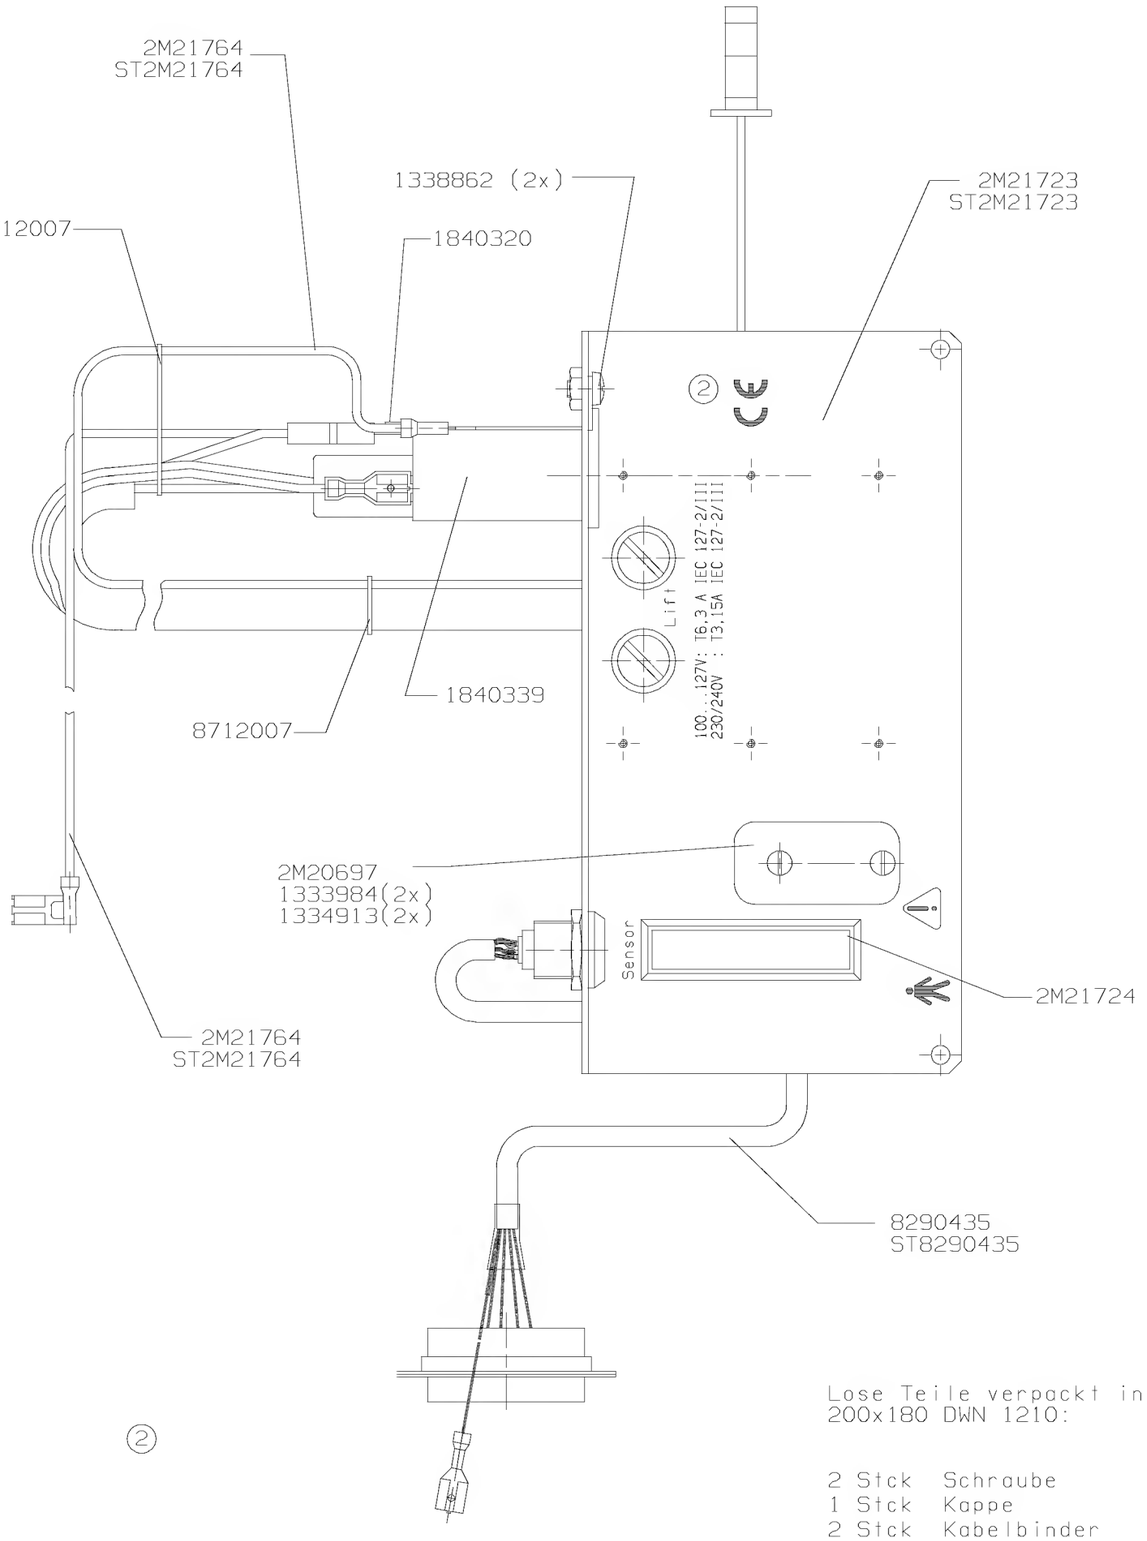

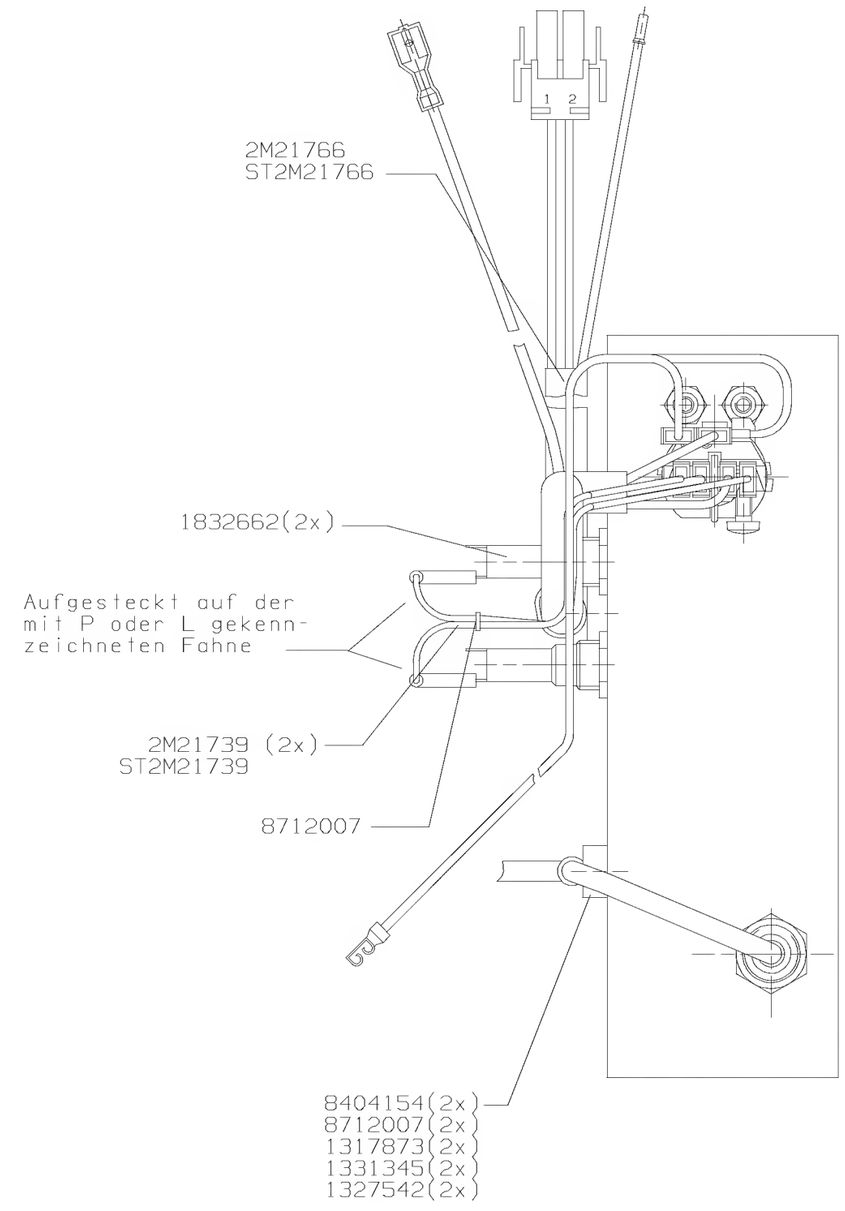

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Copyright Dräger, Lübeck
All rights reserved.
Use of this document / contents is forbidden unless expressly granted. Offenders are liable for damages.

Lose Teile verpackt in Flachbeutel mind. 200x180 DWN 1210:

2 Stck	Schraube	1338382
1 Stck	Kappe	2M20356
2 Stck	Kabelbinder	8712007

ST2M21755

=QA= --	=QB= --	=QC= --					
Werkstoff ---			02	2x	Text gestrichen, CE- Zeichen neu/01.		
					(25/96)		
			Aend. Ziffer	kaeml var	Aenderungen		
Maszstab 1:1	Allgemeintoleranzen ---	Abteilung M2	1996	Tag	Name	Dräger Aktiengesellschaft	
			Bearb	06.02.	NICKE		
			Gepr.	06.02.	Conrad		
				--	--		
ARCHIV	CADRA=8	Benennung Netzanschlusz NC/SC variabel				Zeichnungs-Nr. 2M21755	
						Ersatz fuer 2M21755 00	
						Ersetzt durch	

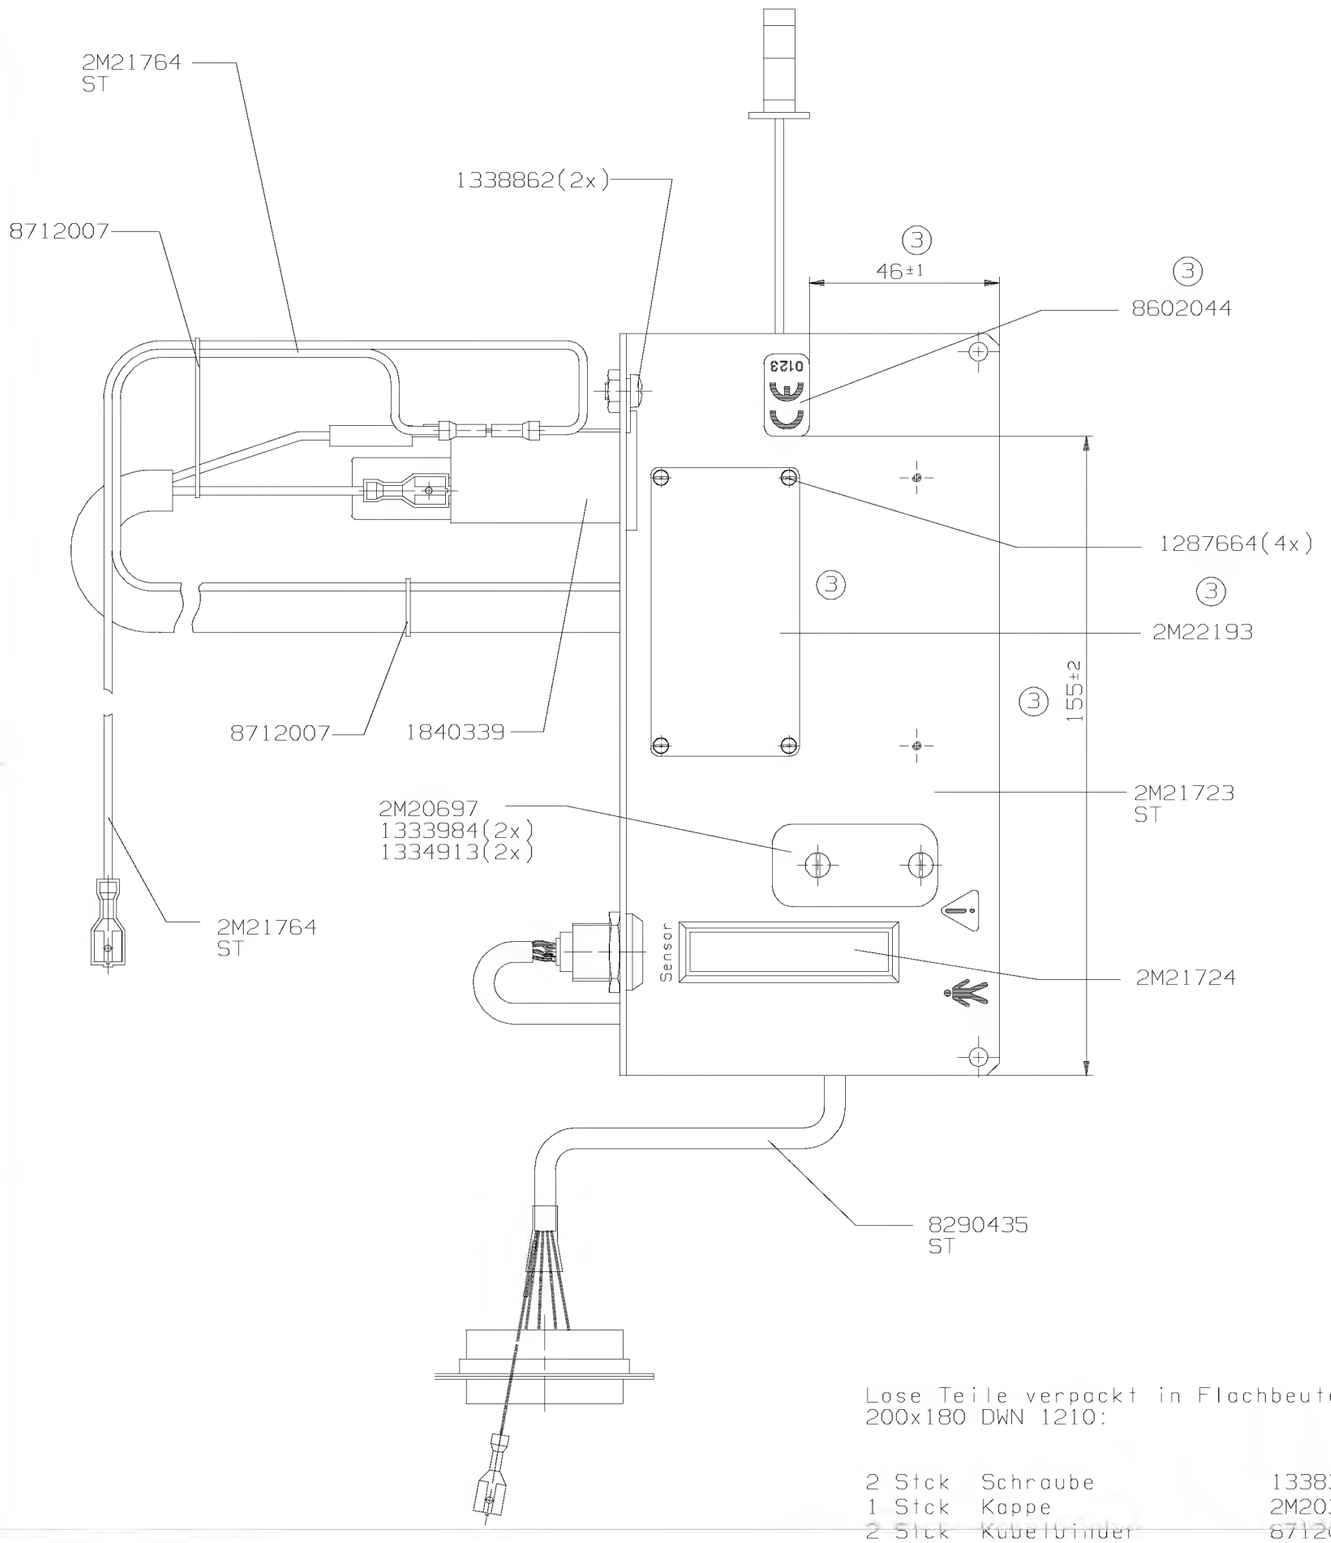

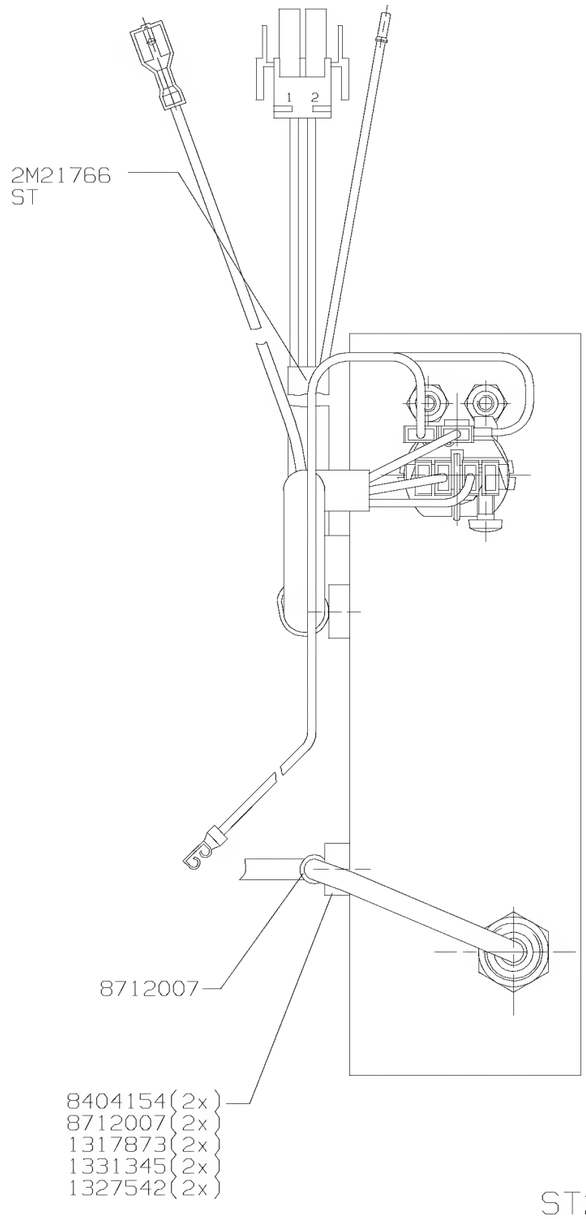

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden.
without permission of Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck.

Lose Teile verpackt in Flachbeutel mind. 200x180 DWN 1210:

2 Stck	Schraube	1338382
1 Stck	Kappe	2M20356
2 Stck	Kabelbinder	8712007

ST2M21754

scale: 1:1	general tolerances: ---	material: ---	safety class: <s> 0, <m> 0
field reserved	revision text: Schild, Abdeckkappe und Masze nachgetragen; Darstellung geaendert (1998/CC/135)		
filing dept.: 2530	responsible dept.: 3401	author: date 27.04.1998, name Stickel	approved: 27.04.1994, Hartwig; contract: n
type: drawing	language: de	title: Netzanschlusz NC/SC, fest	
	replacement for: 2M21754-02	number: 2M21754	
creating system: CADRA	release status: PROD	revision index: 03	accures: 6x; page/of: 01/01

Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A2